



RAPPORT DE VERIFICATION

CERTIFICAT N° 1202021-001

DATE : 12/10/2015

EPI MAINTENANCE

ZA Courtaboeuf
9, avenue du Québec
91140 VILLEBON SUR YVETTE

CONTACT : M. Martin

SERVICE : HSE

Type de matériel : Ensemble PPR 2000

EQUIPEMENT	N° de série	N° client	N° EPI M.
Masque PPR 2000	123456	1234	FC 88502
Moteur PPR 2000	E11L 123456		12345
Batterie PPR 2000	C 01234 - 01/13		67890
Chargeur PPR 2000 - Intelligent			64321

REPARATION / CHANGEMENT DE PIECES / FOURNITURES

Oculaire PPR 2000 anti buée	1
Membrane expiratoire PPR 2000 / PPS	1
Joint moteur/masque PPR 2000	1
Joint filtre/moteur Tornado / PPR 2000	1

TESTS

Intitulé du test	Valeur du test
Masque : Voir résultats POSICHECK	-
Moteur : Courant < 600 mA :	440
Moteur : Débit > à 160 L/min :	160
Batterie : Open voltage > ou = à 3,85 V :	5.17
Batterie : Loaded voltage > ou = à 3,7 V :	3.81
Chargeur : Tension continue (V) :	13.78

COMMENTAIRES

Sans commentaire.

Je certifie que l'équipement ci-dessus a bien été testé et entretenu selon les recommandations et les instructions du fabricant.

Nom et signature du technicien

Gérard Thomas

PROCHAIN CONTROLE : 11/10/2016

Une étiquette portant le n° de vérification est apposée sur chaque appareil après contrôle. Toute disparition ou destruction rendra caduque d'éventuels recours.


Important : Document à garder et à classer comme preuve que votre matériel a bien été testé.

Scott
 PHANTOM
 S/N: E11L 123456

Test Masque
 EPI MAINTENANCE
 Z.A. Courtaboeuf 9, Avenue du Québec
 VILLEBON SUR YVETTE 91140

N° série Posi3 USB U07430 - Etalonnage à jour au moment du test

ID auxiliaires		Tests fonctionnels		
Masque	FC 88502 - 123456	Pression d'expiration	Réussi	0,7 mbar
Soupape a la demand		Fuite Masque	Réussi	0,6 mbar
Détendeur				
Ventilation assistée	E11L 123456 - 12345			
Racc. Bouteille				
Adduction d'air				
Autre ID	1234			
Inspection Visuelle				
Masque	Réussi			

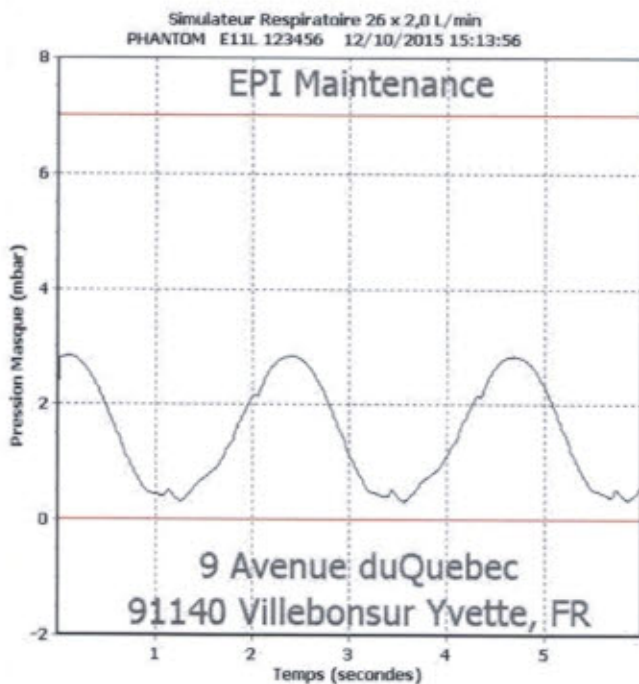

Minimum	Maximum	Résultats de respira	
0,3 mbar	2,9 mbar	Réussi	Pression Masque

Testé par : Hoel Pommier
 E.P.I. MAINTENANCE
 9 Avenue du Québec 91140 Villebon sur Yvette

Signature